


ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

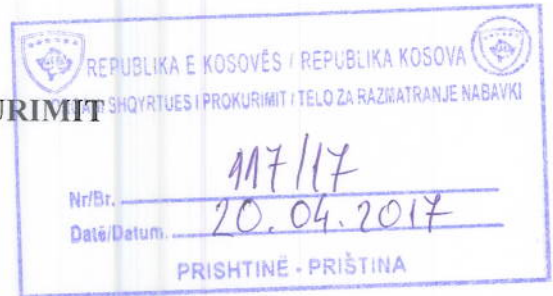

Një ankesë kundër: **SPITALI REGJIONAL - PRIZREN**

(Shëno emrin e Autoritetit Kontraktues)

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **70010 17 172 121 - 04**

(Shëno numrin e Aktivitetit të Prokurimit)

Sa i përket tenderit për : **Furnizim me aparat analajzer biokimik-automatik**

(Shëno titullin e kontratës si në Dosjen e Tenderit)

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

UNI-CARE SH.P.K.

Tel:+377 45 600 910; Fax:+381 38 400 019

Gezim Bajraktari

unicare.ks@gmail.com

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Kalabria, Rr. Lam.A,Blloku C2, Objekti B, Nr.2A

(Adresa)

Prishtinë

10000

(Vendi)

(Kodi postar)

+377 45 600 910

(Numri Telefonit)

+381 38 400 019

(Numri i Faks-it)

Gëzim Bajraktari

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

Rr.Nazim Gafurri Bll.2/6

(Adresa elektronike)

20.04.2017

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe stamper)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar " Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës" apo "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit", afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Data e dorëzimit të Njoftimit të Kontratës në KRPP: 14.02.2017

Afati i fundit për sqarimin e Dosjes së Tenderit: 08.03.2017

Afati i fundit i dorëzimit të tenderit: **17.03.2017** në ora **12:00:00**, Vendi: **zyra e prokurimit nr 7**

Hapja e ofertave të tenderit: 17.03.2017 në 12:30:00 orë, Vendi: zyra e prokurimit nr 8

Kriteret e Dhënies së kontratës:

1. Tenderi i përgjegjshëm me **Çmimin më të ulët**

Me datën 29.03.2017 kemi pranuar letrën standard për sqarime shtesë nga autoriteti kontraktues për përgjigje në fatin kohor **vetëm 2 ditë**.

Kompani Unicare Sh.P.K. ka dorëzura me e-mail autoriteti kontraktues përgjigjet për sqarime e me datën 31.03.2017.

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po	<input checked="" type="checkbox"/>	17.03.2017	ora 12:30	Jo	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	------------	-----------	----	--------------------------

Hapja e tenderit është realizuar me 17.03.2017 në ora 12:30. Në këtë procedure tenderimi kanë ofertuar 5 operatorë ekonomik:

1. Biotek Kosovo LLC: oferta 48'000.00 Euro
2. KEIS ShP.K.: 64'664.00 Euro
3. NTP Buli Medical: 59'841.00 Euro
4. Unicare Sh.P.K.: **38'700.00 Euro**
5. Interlab Sh.P.K.: 58'888.00 Euro

Gjatë hapjes së ofertave kompania Unicare Sh.P.K. ka ofertuar me çmimin dukshëm më të ulët se të gjitha kompanitë tjera **38'700.00 Euro**, duke ofertuar me analajzerin biokimik modelin Architect c8000 që është një nga paraturat më të avancuara në serinë e analajzeri në nivel botëror.

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ? A keni bërë ndonjë reagim me shkrim dhe/ose kërkuar sqarime shtesë nga AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj, si dhe a u është përgjigjur me shkrim AK në lidhje me këtë? Nëse po, ofroni shkurtimisht detaje mbi këtë fakt:

Po	<input checked="checked" type="checkbox"/>			Jo	<input type="checkbox"/>
	04.04.2017				

Autoriteti kontraktues ka dërguar me e-mail letren standarte për tenderuesin e eliminuar me datën 04.04.2017.

Kompania Unicare Sh.P.K. ka reaguar ndaj këtij njoftimi dhe ka deponuar ankesën e nënskruar me arsyetimet përkatëse me datën 07.04.2017

6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Bazuar në dosjen e tenderit dhe në **Ligjit të Prokurimit Publik 04-L042, Neni 52, Pika 1,** Autoriteti kontraktues është përcaktuar që kriter për dhënjen e kontratës është “Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët”. Ne mendojmë se Autoriteti kontraktues ka bërë shkelje të **Ligjit të Prokurimit Publik 04-L042 (LPP 04-L042), Neni-t 6, Pikës 1; dhe me këtë rast fondet publike i tenton t,i shpërdoroj drastikisht duke eliminuar ofertën tonë e cila është rreth 10’000 Euro më e favorshme se oferta pasuese.**

Ne poashtu mendojmë se Autoriteti kontraktues ka bërë shkelje të **LPP-04-042, Neni-t 7, Pikës 1 dhe 2,** me ç’rast nuk ka bërë trajtim të barabartë dhe transparent në mes operatorëve ekonomik të cilë kanë prezentuar ofertat e tyre në këtë tender, madje në mënyrë të njëanshme eliminon konkurrencën dhe diskriminon në dëm, përkatësisht në të mirë të një operatori ekonomik për qëllime të panjohura për ne.

Konsiderojmë se Autoriteti kontraktues ka shkelur edhe **Pikën 3 të Nenit 7, të LPP-04/042 pasi në mënyrë tendencioze dhe me prapavijë dhe pa bazë të vaçantë profesionale ka bërë përcaktimin e specifikacioneve teknike me qëllim që të favorizojë ose diskriminojë një apo më shumë operatorë ekonomik.**

Ne konsiderojmë gjithashtu se Autoriteti kontraktues dhe Komisioni Verësues për ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e ofertave me këtë rast ka bërë shkelje edhe **Neni-t 59 dhe Neni 60, Pikës 1.1. të LPP-04-042.**

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Arsyet e diksualifikimit të ofertës nga kompania Unicare Sh.P.K, sipas autoritetit kontraktues.

Pika 3 – Autoriteti kontraktues thekson se: nuk i plotëson kushtet e kërkuara për shkak të parimit të spektrofotometris

Përgjigje:

Sa i përket kësaj pike, me përgjegjesi të plote deklarojmë se oferta jone ne perpikëri e ofron atë që është kërkuar në specifikat nën pikën 3. Madje ka edhe avatazhe sa i përket kësaj metodologjie. Fotometria është koncept në të cilën mbështetet puna e analizatoreve biokimike të rangut të lartë që për bazë ka “*Concave Diffraction Grating*” dhe në kuadr të kësaj metodologjie përfshihet spektrofotometria, potenciometria, nefelometria dhe të gjitha metodat tjera biokimike. Në bazë të kësaj ju informojmë se spektrofotometria është pjesë e fotometrisë prandaj aparatura e ofruar nga kompania ABBOTT përmbanë spektrofotometrinë dhe ka shtesë edhe metodat tjera prandaj si e tillë e plotëson kërkesat e specifikimeve teknike në tenderin tuaj dhe i tejkalon ato në kuptim të një rangu më të gjerë të spektrit optik.

Derisa spektrofotometria ka vetëm 13 gjatësi valore për leximin e rezultateve, në aparaturën ABBOTT ka mundësi të leximit në 16 gjatësi valore (në 340, 380, 404, 412, 444, 476, 500, 524, 548, 572, 604, 628, 660, 700, 748 dhe 804 nm.) prandaj si e tillë është më e avancuar.

Kompania Unicare në letërën për informacione shtesë ka sqaruar këtë fakt por autoriteti kontraktues i ka anshkalur sqarimet shtesë.

Prandaj konstatimi i autoritetit kontraktues se aparatura e ofruar nga kompania ABBOTT lidhur me këtë pikë nuk qëndron, është në kundërshtim me konstatimin profesional biokimik dhe për më tepër përparësitë e aparaturës biokimike që ne e ofrojmë tenton që ta përshkruaj si mangësi dhe është në kundërshtim me LPP 04/L042 neni 7 pika 3 (si më lartë).

Pika 4 – Autoriteti kontraktues thekson: Në të gjithë dokumentacionin e ofruar nga ana e juaj ne të dhënat për aparatën në fjalë nuk kemi gjetur memorizim më të lartë se 50.000 teste, kërkesa jone është për 100.000 mostra

Përgjigje:

Aparatura e ofruar nga kompania Unicare plotëson kushtin e memorizimit deri në 300.000. Kjo arrihet me sistemin kompjuterik aktual ndërsa broshura i takon periudhës para më shumë se 5 vite ku memorizimi me sistemin Pentium 4 ka qenë në 93000 mostra. Për të kujtuar autoritetit kontraktues sistemi i tillë kompjuterik Pentium IV nuk ekziston që disa vite dhe sistemet e reja të sofwerit mundësojnë arhivimin deri 300.000 mostra.

Prandaj kompania Unicare deklaroi se aparatura e ofruar memorizon deri në 300.000 mostra dhe e tejkalon kërkesat e specifikacioneve në tender dokument.

Pika 10 Autoriteti kontraktues thekson: në asnjë dokumentacion të ofruar nga ana e juaj nuk kemi gjetur se aparatura e tillë disponon me kiveta kuarci por ekzistojnë kiveta të qelqit.

Aparatura e ofruar nga kompania Unicare ka kiveta kuarci dhe deklarojmë edhe një herë se këto kiveta do të ju ofrohen nga kuarci.

Konstatimi I autoritetit kontraktues edhe një herë vë në pah konstatim të padituri së profesionale dhe nuk merre parasysh sqarimet plotësuese të personave përgjegjës të kompanisë ABBOTT.

Për njohurin tuaj ju lutem gjeni një sqarim të personave profesional të fushës së biokimisë:

Disa analizatore ne vehte inkorporojnë kiveta plastike e që duhet të nderrohen kohe pas kohe dhe me se largu çdo gjashtë muaj. Duke pasur parasysh që çmimi i këtyre kivetave është relativisht i lartë si dhe jostabil e kuptojmë nevojën për kiveta permanente të cilat parimisht nuk do të duhej të nderroheshin. Mirepo në anën tjetër, materiali Kuarci është poashtu një lloj qelqi sikurse edhe Boraksi, Pyrexia etj. Të gjitha këto me një emer quhen qelq. Tash, të argumentohet nga ana e komisionit që ne kemi kërkuar kiveta kuarci dhe ju na keni ofruar kiveta qelqi është i pakuptimtë. Ne nuk e kuptojmë argumentin e komisionit për këtë pikë sepse vet komisioni nuk e ka dhënë shpjegimin me argumente shkencore pse insistojnë në kiveta kuarci ndaj atyre nga qelqi, duke theksuar se nuk ka kiveta të qelqit klasik po ka kiveta të materialet permanent si më lartë (Kuarci, Boraksi, Pyrexia).

4. Në letrën e dërguar nga ana juaj për sqarime shtesë në lidhje me pikën "kapacitetet teknike dhe profesionale" të datës 27.03.2017 ju keni vënë në dyshim përmbajtjen dhe Autorizimit nga prodhuesi për pjesëmarrje në këtë tender.

Përgjigje:

Ne edhe për këtë pikë konsiderojmë se vlerësimi juaj është tejet tendencioz me prapavijë të qëllimshme sepse ky dokument original ka ardhur drejtëpërdrejtë nga prodhuesi dhe i adresohet Spitalit Regjional të Prizrenit me qëllim të pjesëmarrjes në tenderin "Furnizim me aparat – analizator biokimik automatik" dhe përshkruhet qartë se autorizohet kompania jonë për të aplikuar në këtë tender duke respektuar të gjitha kërkesat që dalin nga ky dokument përfshirë kërkesën për të dërguar dokument, pjesëmarrjen, ankesat, shitjen, nënshkrimin e kontratës për furnizim, servisimin dhe emërmbajtjen e aparaturës dhe të gjitha aktivitetet e tjera të ndërlidhura me këtë proces tenderimi. Për më tepër në dokumentacion gjenden edhe 3 certifikatë/dëshmi të serviserëve të trajnuar për aparaturën e ofruar përfshirë një certifikatë të përfaqësuesit kryesor të kompanisë UniCare Sh.P.K.

Autorizimi nga prodhuesi gjithashtu i ka të gjitha informatat për kontakt dhe në rast se autoriteti kontraktues ka kërkesa për sqarime të autorizimit ka të drejtën për kontakt dhe sqarime shtesë. Forma e tillë e autorizimit nga kompania ABBOTT Diagnostics na ka përcjellur me shumë se 10 vite nëpër procedura të prokurimit ku ne kemi nënshkruar edhe kontrata me këto autoritete pa ndonjë mangësi në autorizim.

Prandaj konstatim i tillë është i pabazuar, joprofesional dhe lë vend për dyshime në korrektësinë e Autoritetit kontraktues në tenderin në fjalë.

8. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës:

Përfundimisht konstatojmë se arsyetimet e autoritetit kontraktues janë jo të bazuara në konstatime profesionale, janë të dëmshme në aspektin financiar për buxhetin e shtetit të Kosovës (oferta e kompanisë Unicare është në vlerë mbi 10'000,00 Euro), janë dekurajuese për pjesëmarrje në procedura të ardhshme të tenderimit për kompani prestigjioze siç është ABBOTT Diagnostics në përgjithësi dhe humbin besimin në autoritet e prokurimit në Shtetin e Kosovës. Ne presim që vendimi i juaj të rishqyrtohet dhe të vlerësohet drejtë sipas procedurave të përcaktuara nga LPP 04/L042 në të kundërtën ne do të ndjekim edhe instancat tjera të ankesave në sistemin institucionet përkatëse të Kosovës.

9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit".
- një kopje të publikimit për "Njoftimin e Dhënies së Kontratës" apo "Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimit për Anulim".
- një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, dhe
- të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

***Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.