

Republika e Kosovës  
Republika Kosovo – Republic of Kosovo  
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT  
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE  
PROCUREMENT REVIEW BODY

RAPORTI IEKSPERTIT SHQYRTUES

 Ilir Halili Lindita Avdyli 	<i>Data e autorizimit të ekspertit</i> 13.10.2020	<i>Data e dorëzimit të raportit</i> 01.12.2020	Nr. i lëndës:  910/20  913/20
---------------------------------------	--	---	---

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 09.11.2020, OE “Lirimed”- Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 910/20, kundër njoftimit për dhënie të kontratës, lidhur me aktivitetin e prokurimit: **“Furnizim emergjent me material laboratorik për testim për SARS COV-2, me numër të prokurimit: 206-20-3664-1-1-5, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Ministria e Shëndetësisë**.

Me datën: 10.11.2020, OE “Interlab”- Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 913/20, kundër njoftimit për kontratë, kundër njoftimit për dhënie të kontratës, lidhur me aktivitetin e prokurimit: **“Furnizim emergjent me material laboratorik për testim për SARS COV-2, me numër të prokurimit: 206-20-3664-1-1-5, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Ministria e Shëndetësisë**

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës: furnizim, vlera parashikuar Lot 1 = 1,443,730.00 €, Lot 2 = 182,000.00 €.

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

PRETENDIMET ANKIMORE (LIRIMED)

Neni	1	i	LPP-së
Neni	6	i	LPP-së
Neni	7	i	LPP-së
Neni	59	i	LPP-së
Neni	60	i	LPP-së
Neni	62	i	LPP-së
Neni	64	i	LPP-së
Neni	67	i	LPP-së
Neni	69	i	LPP-së

Neni 44.5 i RROUPP-së.

Ndërsa është anuluar njoftimi për dhënie dhe është anuluar në tërësi ky aktivitet i prokurimit.

Vendimi i OSHP-së nuk është i qartë sepse paneli shqyrtues e ka marrë këtë vendim duke mos u



bazuar fare në faktet e prezantuara nga ne dhe gjithashtu nuk janë shqyrtuar në detaje pretendimet tona ankimore dhe dëshmitë e prezantuara me të cilat dëshmi konfirmohet përgjegjshmëria jonë. Ndërsa konstatimet e OSHP-së në lidhje me papërgjegjshmërinë tonë nuk qëndrojnë fare pasi që ne i kemi ofruar sqarimet e qarta se ne i përmbushim kërkesat e FDT-së dhe të njoftimit për kontratë, mirëpo OSHP-ja vetëm është bazuar në nenin 39 të RRUOPP-së, duke mos dhënë asnjë sqarim tjetër në lidhje me pretendimin tonë. Ne kemi kërkuar rivlerësim, pasi që kemi dorëzuar ofertë të përgjegjshme, ndërsa nuk kemi kërkuar anulim në ankesën tonë. Kërkojmë nga OSHP të shqyrtohen pretendimet tona dhe të nxirret vendim meritore në bazë të fakteve, argumenteve dhe kërkesës tonë.

Në lidhje me arsyen tonë të eliminimit nga ana e AK-së ju sqarojmë edhe një herë se ne jemi OE i përgjegjshëm dhe se eliminimi ynë nga ky aktivitet i prokurimit është i pa bazuar për faktin se nëse AK-ja ka pasur ndonjë dilemë në lidhje me katalogjet e ofruara nga ne, ka pasur mundësi që në bazë të dispozitave të nenit 59.2 dhe 72 të LPP-së të kërkojnë sqarime shtesë nga kompania jonë apo eventualisht edhe nga prodhuesit, pasi që ne i posedojmë autorizimet të cilat edhe i kemi prezantuar në ofertën tonë, mirëpo që ne jemi diskriminuar nga ana e AK-së pasi që nuk janë kërkuar sqarime shtesë fare. Te bashkangjitur gjëni edhe katalogun nga prodhuesi Singuëay për kete tender ku mund të shihet se jemi plotësisht në harmoni me kërkesat e dosjes së tenderit dhe specifikimet teknike.

Ndërsa referimi i AK-së tek neni 39.8 i RRUOPP-së nuk përkon fare me realitetin e dosjes së tenderit të dorëzuar nga ne, pasi që dosje të tenderit nuk është kërkuar që specifikimet teknike të ofrohen veçantë katalogeve, madje nuk është cekur decidivisht që katalogjet duhet të përmbajnë specifikime teknike por është cekur vetëm për broshurat. Dispozita e nenit 59.2 të LPP-së e thotë qartë që sqarim mund të kërkohej mbi cilindo aspekt të tenderit dhe ligji është akt me i lartë ligjor se sa aktet tjera nënligjore e leje më se sa RRUOPP, prandaj në këtë rast eventualisht ka mundur të shfrytëzohet neni 59.2 i LPP-së, sidomos kur kemi parasysh faktin se ne jemi ofertues më i lirë nga të gjithë operatorët ekonomik pjesëmarrës, në këtë aktivitet të prokurimit.

Ne me dt. 29.10.2020 kemi marrë përgjigje në kërkesën për rishqyrtim ku autoriteti kontraktues, e ka cekur se nuk mundet ta shqyrtojë kërkesën tonë për rishqyrtim pasi që me vendim të OSHP-së është anuluar ky aktivitet i prokurimit.

Ky arsyetim i AK-së për mos shqyrtimin e kërkesës tonë për rishqyrtim është i pa bazuar dhe me këtë veprim të saj AK-ja nuk e ka respektuar nenin 108/A. Pasi që nuk është e ndaluar me asnjë dispozitë ligjore të bëhet ankesë kundër një vendimi që po na dëmton neve si kompani e përgjegjshme. Pra AK-ja nuk i ka respektuar dispozitat e nenit 108/A, duke mos e shqyrtuar kërkesën tonë për rishqyrtim, pasi që kërkesa për rishqyrtim dhe tani ankesa janë parashtruar më pretendimet plotësisht të bazuara, sepse oferta jonë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit nuk është vlerësuar siç duhet nga ana e autoritetit kontraktues.

Duke u bazuar në të gjitha sqarimet që i kemi cekur më lartë, rezulton se anulimi i këtij aktiviteti të prokurimit është bërë në kundërshtim me nenin 62 të LPP-së dhe në kundërshtim me nenin 44.5 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik, sepse asnjëra nga kushtet e parashikuara në këto dispozita nuk janë përmbushur, për shkak se ne jemi ofertues i përgjegjshëm.

Gjithashtu ju sqarojmë se OE i rekomanduar për kontratë është i papërgjegjshëm pasi që nuk i ka plotësuar të



gjitha kërkesat e FDT-së dhe të njoftimit për kontratë, pasi që nuk i ka ofruar autorizimet e prodhuesit, mirëpo i ka ofruar nga distributori i tij, andaj shihet qartë se OE i rekomanduar për kontratë është i përgjegjshëm.

Duke u bazuar në dëshmitë dhe faktet që u cekën më lartë rezulton se ekzaminimi vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve nuk është bërë në harmoni me nenin 59 të LPP-së dhe njëkohësisht nuk është respektuar edhe kriteri kryesor për dhënie të kontratës, e që ka qenë tenderi i përgjegjshëm me çmim më të ulët sipas neni 60 paragrafi 1.1 i LPP-së.

Gjithashtu AK-ja nuk e ka respektuar edhe nenin 7 i LPP-së, duke na diskriminuar neve si operator ekonomik, edhe pse i kemi plotësuar të gjitha kërkesat e FTD-së dhe të njoftimit për kontratë, nuk jemi shpallur fitues të këtij tenderi.

Gjithashtu autoriteti kontraktues nuk e ka respektuar edhe nenin 6 të LPP-së, sepse janë të obliguar që të sigurojnë që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike, njëkohësisht duke marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit.

Po ashtu autoriteti kontraktues nuk e ka pasur në konsideratë edhe nenin 1 të LPP-së, pasi që dihet se qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë.

Duke u bazuar në dëshmitë që u cekën më lartë, kërkojmë nga OSHP që të merr:

#### VENDIM

**APROVOHET** ankesa e OE “Liri-Med” si e bazuar,  
**ANULOHET**, njoftimi dhe vendimi i AK-së për anulim të aktivitetit të prokurimit dhe lënda kthehet në **RIVLERËSIM**,  
**DETYROHET** autoriteti kontraktues që gjatë rivlerësimit, ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i ofertave të bëhet në harmoni me kërkesat e dosjes së tenderit, njoftimit për kontratë dhe konform dispozitave të LPP-së.

Nëse nuk merren parasysh faktet tona, ne jemi të detyruar të vazhdojmë procedurën ligjore në institucionet tjera kompetente.

#### **Dëmet material:**

Neve si Operator Ekonomik na janë bërë dëme materiale për përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës, në vlerë prej 5,000,00 euro

#### **DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE (INTERLAB)**

**Neni 1 - Qëllimi**

**Neni 7 - Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi**

### Neni 59 - Ekzaminimi, Vlerësimi dhe Krahësimi i Tenderëve


OE Interlab shpk si pale pjesëmarrëse dhe e paknaqur në këto aktivitete të prokurimit publik, pas pranimit të vendimit të AK-se për anulim vërejmë qartë se kompania jone Interlab shpk edhe pse ka qenë e përgjegjshme si në anën administrative e poashtu edhe sipas kërkesave teknike nga ana e njesise kerkuese është eliminuar padrejtesisht.

Pas pranimit të vendimit të OSHP-se ne mendojme se OE Viteq ka ofruar deshmi të rrejshme në ankesën e tij të parashtruar në Organin Shqyrtues të Prokurimit Publik.

Ne si OE posedojmë deshmi "Deklarata" nga prodhuesit të cilat deshmojnë se ne kemi ofruar produkte të prodhuara nga këta prodhues, e jo të ofruara nga distributorët.

Llot 1:

LABID technologies për artikullin nr. 18 të ofruar me product code: NOMP-IB për të cilin OE Viteq si pjesëmarrës ka pretenduar se kompania LABID nuk është prodhues, ndërsa ne ju bashkangjitem edhe foton e produktit i cili gjendet në ëb të prodhuesit e poashtu edhe deklaratën nga prodhuesi ku e rikonfirmon se këto produkte prodhohen nga ky prodhues:

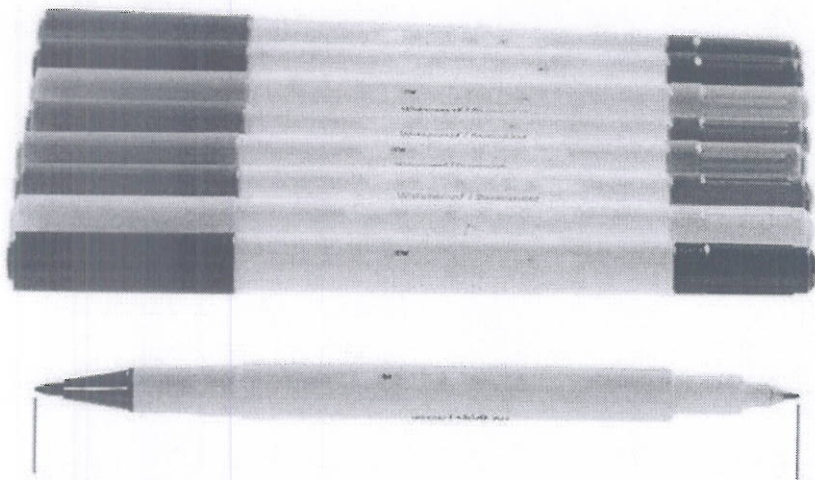



labid technologies

Manufacturer Declaration

Date 26 10 2020

Title: 'Furnizim Emergjent me material laboratorik për testim për SARS-COV-2 \*

Procurement No. 206-20 3664-1-1-5

To Ministry of Health

Është LobID Technologies B.V. deklaruar se produktet ofruar siç është përshkruar më poshtë nëpërmjet kompanisë 'Interlab shpk' për këtë projekt:

Product code: NOMP 1B

Are LobID brand and labeled by LobID Technologies B.V.

Signed: 26.10.2020

Name: R.M Antonie

Tel: >31(0)73-737 00 57  
Fax: >31(0)73 737 01 16  
Email: [support@labid-technologies.eu](mailto:support@labid-technologies.eu)  
Është: [www.labid.eu](http://www.labid.eu) / [www.labid-technologies.eu](http://www.labid-technologies.eu)

<https://www.labid.eu/en/labid-dual-tip-cryo-marker-weatherproof-permanent.html>

Per artikullin 33: PAPR systems, ne si OE kemi ofruar produkt te prodhuesit Bullard per te cilin kemi ofruar edhe autorizim nga prodhuesi Bullard.

Ne si dëshmi ju bashkangjesim një CE deklarate e pasqyruar edhe deklaraten nga prodhuesi se per produktin EVA Papr system i vetmi prodhues ne bote eshte Bullard.

**miBullard**

EC DECLARATION OF CONFORMITY

**The manufacturer:**

E D. Bullard Company  
1893 Safety Way  
Cynthiana, KY 41031 • USA  
877-BULLARD (285-5273)  
edd.Bullard.com

**Authorized Representative in  
the European Community:**

Bullard GmbH  
Dieselstrasse 8a  
53424 Remagen, Germany  
+49-(0)2 642-99998-0

**hereby, declares that the PPE described hereafter:**

**Powered Air Respirator comprising of:**

EVA1 - PAPR hood and belt  
PA1BT - Breathing tube: S or M or L  
EVABAT1 - rechargeable lithium polymer battery 16.5VDC  
EVASMC - battery charger for the EVABAT1

**Hood Tops (TH3):**

RT3  
RT4  
20TIC  
20SIC  
20LFL  
20LFM  
20LF2L  
20LF2M  
20LF2S

**Hood Tops with Hard Hat (TH2):**

20TICH Hood &/ hardhat  
20SICH Hood &/ hardhat  
20SICVH Hood &/ hardhat

**Filter**

PAPRFC3 - Hepa - Classification P3 R SL  
PAPRFC4 Combined filter - Classification A2 P3 R SL

**is in conformity with the provisions of Council Directive 89/686/EEC and with the  
harmonised standard EN12941:1998/A2:2008.**

**is identical to the PPE which is the subject of EC certificate of conformity No. 2248  
issued by INSPEC International Ltd, 56 Leslie Hough Way, Gtr Manchester, M6 6AJ,  
England.**

**is subject to the procedure set out in Article 11 Section B of Directive 89/686/EEC  
under the supervision of the notified body INSPEC International Ltd.**

Signed:

Brian Sutton  
Global Compliance Manager  
Date: 26 March 2020





Per prodhuesin Carl Roth per te gjitha produktet e ofruara nga ky prodhues per kete aktivitet te prokurimit kemi ofruar produkte te cilat prodhohen nga ky prodhues:



CarlRothGmbH & Co KG Postfach 1001 71 D-76231 Karlsruhe

**KompetenZ fur daS Labor**

Laborbedarf Life Science Chemikalien

Competence for the Laboratory

Labvvare Life Science Chemicals

### Manufacturer Declaration

Title: "Furnizim Emergjent me material laboratorik për testim për SARS-COV-2 "

Procurement No. 206-20-3664-1-1-S

To: Ministry of Health

Ee Carl Roth declare that the products offered as described below through the company "Interlob shpk" for this project:

Atr6.1  
H608.1  
N  
£706.1

199.1

Are Carl Roth brand and labeled by Carl Roth


Carl Roth GmbH + Co KG  
Schoemperdstraße 3  
76185 KARLSRUHE  
Telefon 07 71 / 56 06-0

Name: Wolfgang Treffinger (Export Manager)


Signed on behalf of Carl Roth GmbH & Co.KG



Per artikullin 1.4: Eshte kerkuar Sterile aerosol barrier tips 10-100 pl, ndersa ne kemi ofruar Sterile Aerosol Barrier Tips me range nga 0-100 ul. Pra i njeiti produkt identik sic eshte kerkuar nga AK dhe e cili i permbush kerkesat e AK sipas specifikimeve teknike.



Per artikullin 1.5- Eshte kerkuar Sterile aerosol barrier tips 50-1000 pl, ndersa ne kemi ofruar Sterile Aerosol Barrier Tips me range nga 0-1000 ul. Pra i njeiti produkt identik sic eshte kerkuar nga AK dhe e cili i permbush kerkesat e AK sipas specifikimeve teknike.

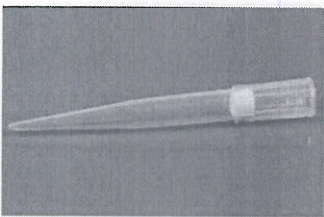

Per artikullin 1.7 Ethanol 80% - Ne kemi ofruar produkt nga prodhuesi Carl Roth i cili eshte me graden Molecular Biology Grade dhe i cili e ofron paketimin 1L.

Per artikullin 1.8 Ethanol 96% - Ne kemi ofruar produkt nga prodhuesi Carl Roth i cili eshte me graden Molecular Biology Grade dhe i cili e ofron paketimin 1L.

Per artikullin 1.10 Transport Case for in-house sample transport eshte kerkuar me dimensione: 360x310x275 mm ndersa ne kemi ofruar produkt me dimensione me te medha dhe eshte produkt me i avancuar se ai i kerkuar ne FDT 445x320x390 e cila lejohet sipas LPP-se

Per artikullin 1.11 Transport Case me dimensione 395x395x435 mm ndersa ne kemi ofruar produkt me dimensione me te medha dhe eshte produkt me i avancuar se ai i kerkuar ne FDT 620x400x350 mm e cila lejohet plotesisht sipas LPP-se.

Per artikullin 1.22 Sharp Box Container me Volume 20-22 L ndersa ne kemi ofruar produkt me vellim me te madh dhe eshte produkt me i avancuar se ai i kerkuar ne FDT "23Liter" e cila lejohet plotesisht sipas LPP-se.

Per artikullin 1.23 Sharp Box Container me Volume 6 L ndersa ne kemi ofruar produkt me vellim me te madh dhe eshte produkt me i avancuar se ai i kerkuar ne FDT "7 Liter" e cila

lejohe plotesisht sipas LPP-se.

Per artikullin 1.31 EoundPads eshte kerkuarsipas DT me dimensione 1.5-3 cm ndersane si OE kemi ofruar produkt me dimensione sipas kerkeses se AK-se.

Per artikullin 1.32 "Kuti per vendosjen e epruvetave" Storage Box eith lid eshte kerkuar me kapacitet te vendosjes se epruvateve me vellim 1.5 apo 2 ml ndersa ne kemi ofruar kuti per vend te epruvetave me kapacitet 0.2 ml apo 1.5ml apo 2 ml e cila eshte plotesisht sipas kerkeses se AK-se.

Per artikullin 1.35 - Blood Collection tubes for serum dimensionet e kerkuara Tubes of 16.8 mm; minimum 7.5 ml ndersa ne si OE kemi ofruar produkt "Epruvete gjaku" me vellim 8 ml i cili lejohet sipas LPP-se.

Llot 2: Pas pranimitte vendimit te OSHP-se me numer: 622, 627/20 mendojme se ka mundur te rrjedh ndonje gabim teknik pasiqe ne vendimin e OSHP-se nuk jane trajtuar dhe nuk ka pretendime per te cilat ne nuk i plotesojme specifikimet apo kriteret te percaktuara ne DT, dhe arsye per tu anuluar llot 2 te ketij aktiviteti te prokurimit publik.

Duke vleresuar lart shume profesionalizimin e Organit Shqyrtues te Prokurimit Publik dhe duke marre parasysh gjendjen shume te veshtire te situates se krijuar nga Covid 19, besojme larte se vendi i Kosoves ka nevoj me shume se kurr per keto paisje ne menyre qe te behet testimi masiv i popullates se Kosoves e me kete duke parandaluar shume perhapjen e virusit dhe perfundimin me fatalitet te ketyre rasteve.

Kerkojme nga Paneli Shqyrtues qe lenden ta kthej ne rivlersim, dhe te na shpalle si fitues pasiqe jemi e vetmja kompani me oferten me te favorshme dhe te pergjegjshme si ne pjesen administrative e poashtu edhe ne pjesen e specifikimeve teknike.

#### Dëmet Materiale:

Mohimi i te drejtës për ta fituar tenderin ne fjale, përkundër plotësimit te kërkesave ne përputhje me Dt. shpenzime te resurseve humane dhe financiare ne përgatitjen e ofertës.

Ngarkesa dhe shqetësime qe na përcjellin me rastin e padrejtësive nga AK.

Ulje e kredibilitetit te kompanis sonë si dhe humbja e besimit për te marr pjesë ne aktivitet tjera.

#### KRITERET PËR VLERËSIM

Vlera e parashikuar	2.4	Lot 1 = 1,443,730.00 €, Lot 2 = 182,000.00 €.
---------------------	-----	--



Specifikacionet teknike të detyrueshme	3.1	Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentet dëshmuuese për qëllimin e ofruar të kontratës, duke përfshirë: a. Deklaratën për specifikacionet teknike për shërbimet e ofruara të cilat përputhen me ato të përmendura në Aneksin 1 të dosjes së tenderit; b. Tregues i numrit të pjesë(ve) që mbulohen në tender, nëse është e aplikueshme;	
Siguria e ekzekutimit	6.1	[Nëse kërkohet siguria e ekzekutimit] Në rast të dhënies së kontratës juve, ju duhet të ofroni para nënshkrimit të kontratës, sigurinë e ekzekutimit.	
	6.2	Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është: 30 % e vlerës totale të Kontratës për periudhën 7 Muaj.	
Pranueshmëria e Operatorëve Ekonomik	6.4	Kërkesat e përshtatshmërisë:	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>
		1. Një deklaratë e shkruar nën Betim, e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën në Aneksin 2.	1. Deklarata nën Betim.
		2. Për situatën referuar pikës 6.3 [h (tatimit)], vërtetim i lëshuar nga Administrata Tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është delikuent (shkelës) në pagesën e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit [para publikimit të Njoftimit për dhenje të Kontratës]	2. Vërtetim i lëshuar nga Administrata Tatimore – kërkohe vetem për fituesin (jo më e vjetër se tre muaj) – kopje.
		3. Për situatën referuar pikës 6.2 [a,c,d, e dhe f] dhe pikës 6.3 [a,b dhe d], vërtetim i lëshuar nga gjykata kompetente apo autoritetet administrative të vendit të themelimit të tenderuesit.	3. Vërtetim i lëshuar nga gjykata kompetente – kërkohe vetem për fituesin (jo më e vjetër se gjashtë muaj).

Kërkesat e përshtatshmërisë profesionale	7.1	Përshtatshmëria profesionale	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>
		1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe/apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit.	1. Certifikata e regjistrimit të biznesit – kopje.
		2. Regjistrimi në regjistrin Fiskal.	2. Certifikata e Numrit Fiskal – kopje.
Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ ose profesionale	9.1	3. Certifikata për TVSH për secilin partner të një grupi operatorësh ekonomik – kjo vlen vetëm për kompanitë e regjistruara në Kosovë.	3. Certifikata e TVSH-se – kopje.
		Kapaciteti teknik dhe profesional	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>
		1. Kërkohet që OE të jetë i regjistruar në AKPPM si qarkullues me shumicë të produkteve dhe pajisjeve medicinale (me validitet).	1. Licenca nga AKPPM si qarkullues me shumicë të produkteve dhe pajisjeve medicinale (me validitet) – Kopje.
		2. Kërkohet që OE të ofroj katalogun ose broshurën për artikujt e ofruar.	2. Katalogu ose broshura me përshkrimin e artikujve dhe specifikimeve të ofruara.
		3. Kërkohet që OE të deklarojë se do ta bejë furnizimin jo më vonë se 10 ditë nga marrja e porosisë për Lotin 1 dhe jo më vonë se 30 ditë për lotin 2.	3. Deklaratë për afatin e furnizimit jo më vonë se 10 ditë për Lotin 1 dhe jo më vonë se 30 ditë për Lotin 2 nga marrja e porosisë.
		4. Operatori ekonomik duhet të dëshmojë se është i autorizuar nga prodhuesi për tenderin përkatës.	4. Autorizim nga prodhuesi për tenderin përkatës (me të dhëna mbi prodhuesin adresë, nr. tel, email, ëeb faqja etj, për mundësi të verifikimit.



## **RAPORTI I KOMISIONIT VLERËSUES (VENDIMI PER RISHQYRTIM-LIRIMED)**

### **NJOFTIM**

Autoriteti Kontraktues - Ministria e Shëndetësisë, nuk mund ta shqyrtoj Kërkesën tuaj për Rishqyrtim, meqenëse bazuar ne Vendimin e OSLIP-së me nr. 622-627/20 te datës 09.10.2020 është anuluar tenderi "Furnizim Emergjent me material laboratorik për testim për SARS-COV-2", me numër prokurimi 206-20-3664-115 dhe numër te brendshëm 206-20-38-115.

## **RAPORTI I KOMISIONIT VLERËSUES (VENDIMI PER RISHQYRTIM-INTERLAB)**

### **NJOFTIM**

Autoriteti Kontraktues - Ministria e Shëndetësisë, nuk mund ta shqyrtoj Kërkesën tuaj për Rishqyrtim, meqenëse bazuar ne Vendimin e OSLIP-së me nr. 622-627/20 te datës 09.10.2020 është anuluar tenderi "Furnizim Emergjent me material laboratorik për testim për SARS-COV-2", me numër prokurimi 206-20-3664-115 dhe numër te brendshëm 206-20-38-115.

## **INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIMEVE TË KERKUARA NGA E EKSPERTËVE SHQYRTUES DHE / OSE TEKNIK**

## **VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP-së**

## **VENDIMET E MËPARSHMETË PSH-së LIDHUR ME RASTET E NGJASHME**

## **ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME**

## **PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES “LIRIMED” - PRISHTINË**

### **Përgjigje në Pretendimi nr.1**

Lidhur me pretendimin ankimor të OE ankues Lirimed-gjegjësisht arsye e eliminimit të tij, eksperti shqyrtues teknik sqaron se me ankesë të paraqitur në OSHP , operatori ekonomik ka ofruar edhe katalogun për pozicionet të cilat janë kontestuar nga ana e AK-së për shkak të mungesës së specifikimit teknik.

Eksperti shqyrtues teknik sqaron se (ashtu siq pretendon OE Lirimed) në dosje të tenderit nuk është kërkuar specifikacioni teknik ndaras nga katalogu, andaj vlerësojmë se në mungesë të katalogut të OE Lirimed, AK në pajtim me nenin 39 të RRUOPP-së ka mund të kërkoj sqarime shtesë nga OE.

Bazuar në gjitha këto u cekën më lart vlerësojmë se pretendimi ankimorë i OE ankues Lirimed është i bazuar dhe rekomandojmë që gjatë rivlerësimit AK-MSH të marr parasyshë sqarimet e ofruara nga OE ankues Lirimed.

## **PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES “INTERLAB” - PRISHTINË**

### **Përgjigje në Pretendimin nr.1**

Pas shqyrtimit të ankesës dhe analizimit të ofertës të OE ankues Interlab, eksperti shqyrtues teknik vlerëson se sa i përket artikujve me ; nr.1.4, nr.1.5, nr.1.7, nr.1.8, nr .1.31, nr.1.32, nr.1.35 janë në pajtim me kërkesat e dosjes së tenderit.

Ndërsa për artikujt nr.1.10 dhe 1.11 transpor case (kuti transportuese) OE Intelab i ka ofruar me diemnsione më të mëdha se që janë kërkuar në dosje të tenderit.

Për pozicionet nr.1.22 dhe nr.1.24 OE ankues ka ofruar produkt me vëllim më të madh se që është kërkuar në dosje të tenderit, poër poz.1.22 është kërkuar vëllim 20-22 litra ndërsa OE ka ofruar 23litra.

Ndërsa për pozicionin 1.24 ëshë kërkuar vëllim 6 litra ndërsa OE ankues ka ofruar rproduktin me vëllim 7 litra.

Bazar bazuar në këto që u cekën më lart, eksperti teknik dhe ai shqyrtues vlerësojnë se ankesa e OE Interlab është pjesërisht e bazuar.

## **MENDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES**

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti teknik dhe eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE-e Lirimed të aprovohen si e bazuara, ndërsa ankesa OE Interlab të aprovohet si pjesërisht e bazuar.

Raporti i eksperizës ti dorëzohet:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - Autoritetit Kontraktues | - MSH.      |
| - Panelit Shqyrtues       | - OSHP.     |
| - OE ankues               | - Lirimed.  |
| - OE ankues               | - Interlab. |
| -                         |             |